

**Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений
на приобретение реагентов для кдл лаборатории для оказания гарантированного
объема бесплатной медицинской помощи в ГККП «Областной центр крови»**

г. Актау

05.03.2018 года

В 12:00 часов 05 марта 2018 года произведена процедура вскрытия конвертов с заявками по закупу объявленным 26.02.2018 года способом запроса ценовых предложений приобретение реагентов для кдл лаборатории для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, по адресу:

- Г.Актау, 34А мкр., здание центр крови.

1. Конверты в запечатанном виде с ценовыми предложениями нижеследующих потенциальных поставщиков были представлены своевременно, до истечения окончательного срока указанные на веб-сайте предприятия «ock.mangystau.kz»

№ п/п	Наименование поставщика	Номер лота,наименование товара	Юридический адрес поставщика	Время представления по жураналу
1	ТОО «Бакас-Акцент»	№ 1- Uriscan тест индикатор для мочи № 2- Uritrol 1,2,3(контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп № 3- Термолента 57мм*30м	Г.Актау, 12 мкр., 42 дом, 43 кв	05.03.2018 09:26:00

2. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг-прилагается протоколу об итогах.

3. Рассмотрев представленные ценовые предложения Поставщиков,

РЕШИЛ:

- 3.1. По лотам 1,2,3 - признать закуп несостоявшимся, так как был представлен конверт одним потенциальным поставщиком**

Директор ГККП «Областной центр крови»

Мангистауского областного

Управления здравоохранения

Сарсамалиев Р.В.

Уполномоченный представитель

Организатора закупок,

Менеджер по гос.Закупкам

Дүйшова П.Қ.

Приложение к протоколу
итогов от 05.03.2018 г.

№ лота	Наименование товаров	Описание товара	Ед.изм	Кол-во	Выделенная сумма для закупок за ед.	ТОО «Бакас-Акцент»
1	Utiscan тест индикатор для мочи	Тест полоски Utiscan 11 для проведения биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитраты, глюкоза, рН,S/G, лейкоциты, аскорбиновая кислота) на полуавтоматическом анализаторе мочи Utiscan optima, поставляется в тубе 100шт в уп. упакованной в картонную коробку, температура хранения +2+30 C	уп	20	9 457	9 200
2	Uritrol 1,2,3(контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп	Uritrol 1,2,3(контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп. Служит для обеспечения надежности и точности результатов анализатора Utiscan optima, поставляется в картонной коробке(3фл в уп) температура хранения +2+8 C	набор	3	7 034	6 900
3	Термолента 57мм*30м	Термолента 57мм*30м предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Utiscan optima	рулон 57 мм	5	500	300



Директор

Сарсамалиев Р.В.

**Протокол об итогах закупа способом из одного источника на приобретение реагентов
для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в ГККП
«Областной центр крови»**

Г.Актау

05.03.2018 года

1. Организатор/Заказчик закупок: ГККП «Областной центр крови», 34А мкр., здание центр крови, провела закуп способом из одного источника на основании п.п 2) п.116 по Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее-Правила) по закупке изделий медицинского назначения осуществляет закуп способом из одного источника, так как закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися.

2. Сумма, выделенная для закупок 212 742 (двести двенадцать тысяч семьсот сорок две) тенге 00 тиын.

3. Соответствие поставщика квалификационным требованиям главы 3 и 4 Правил, а также требованиям, установленным п.117 главы 11 Правил - соответствует.

4. Краткое описание закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг (приложение №1 к протоколу).


5. Цена договора составляет: 206 200 (двести шесть тысяч двести) тенге 00 тиын.

6. Организатор закупок по результатам данных закупок способом из одного источника

РЕШИЛ:

1. Заключить договор на закуп изделий медицинского назначения с ТОО «Бакас-Акцент» Мангистауская обл., г.Актау, 12мкр., 42 дом, 43 кв.
2. В срок до 14 «марта» 2018 года опубликовать на интернет ресурсе osk.mangystau.kz данный протокол итогов.

Директор

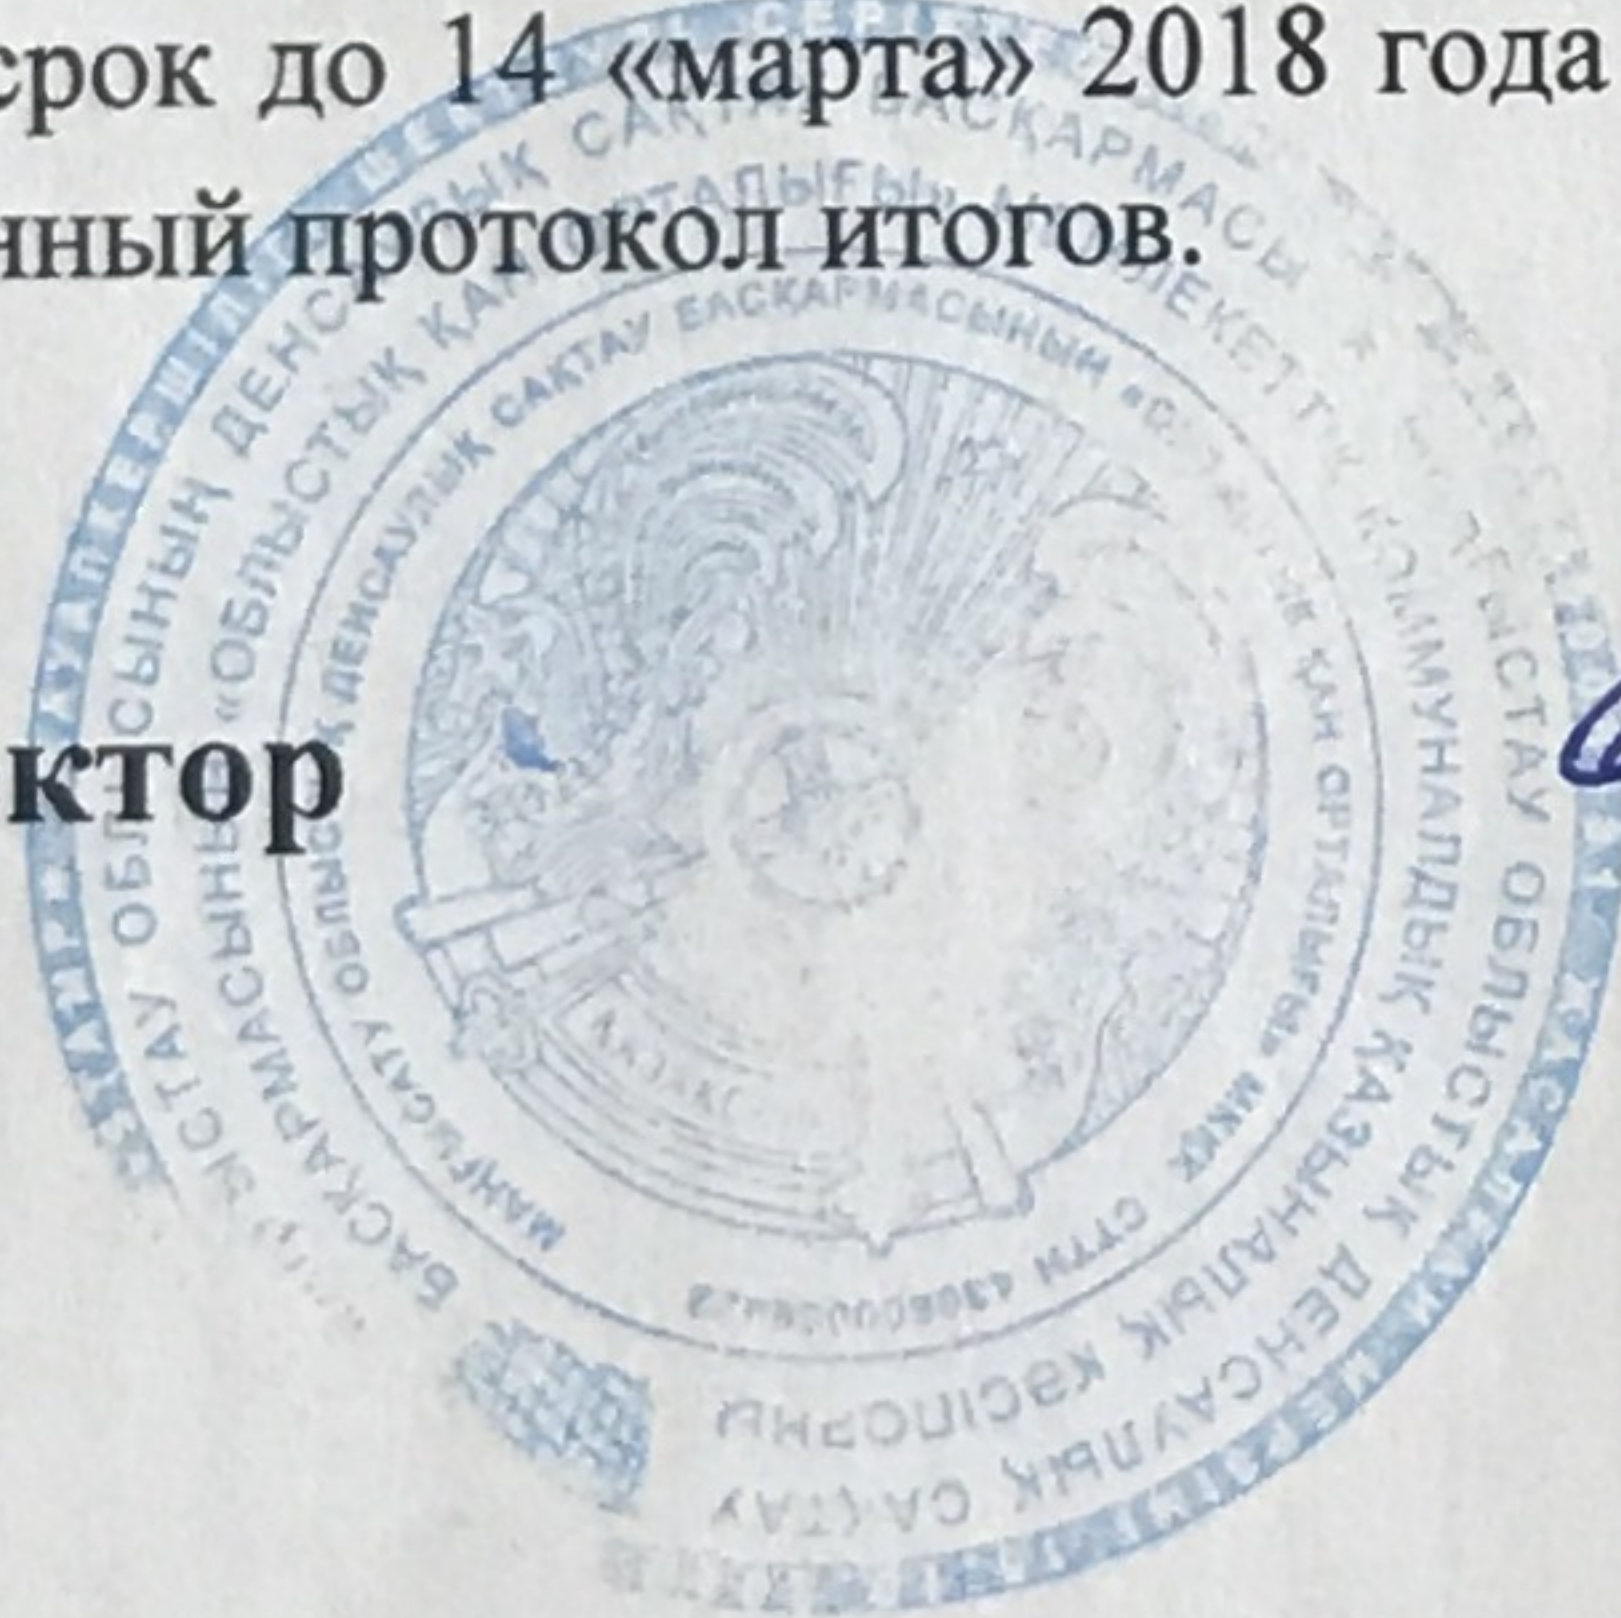

Сарсамалиев Р.В.

Приложение к протоколу
итогов от 05.03.2018 г.

№ лота	Наименование товаров	Описание товара	Ед.изм	Кол-во
1	Uriscan тест индикатор для мочи	Тест полоски Uriscan 11 для проведения биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитраты, глюкоза, рН, S/G, лейкоциты, аскорбиновая кислота) на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima, поставляется в тубе 100шт в уп. упакованной в картонную коробку, температура хранения +2+30 С	уп	20
2	Uritrol 1,2,3(контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп	Uritrol 1,2,3(контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) 3фл/уп. Служит для обеспечения надежности и точности результатов анализатора Uriscan optima, поставляется в картонной коробке(3фл в уп) температура хранения +2+8 С	набор	3
3	Термолента 57мм*30м	Термолента 57мм*30м предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima	рулон 57 мм	5

Директор

Сарсамалиев Р.В.

