

**Протокол об итогах закупа способом запроса ценовых предложений  
на приобретение реагентов для оказания гарантированного объема бесплатной  
медицинской помощи в ГККП «Областной центр крови»**

г.Актау

12.02.2018 года

В 12:00 часов 09 февраля 2018 года произведена процедура вскрытия конвертов с заявками по заупу объявленным 01.02.2018 года способом запроса ценовых предложений приобретение реагентов для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, по адресу:

- Г.Актау, 34А мкр., здание центр крови.

1. Конверты в запечатанном виде с ценовыми предложениями нижеследующих потенциальных поставщиков были представлены своевременно, до истечения окончательного срока указанные на веб-сайте предприятия «ock.mangystau.kz»


| № п/п | Наименование поставщика | Номер лота,наименование товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Юридический адрес поставщика                               | Время представления по журналу |
|-------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1     | ТОО «ШерКомСервис»      | № 32 - Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинового Времени 5*2 мл, (эллаговая кислота)<br>№ 33 - Набор реагентов для определения Протромбинового Времени 5*2 мл<br>№ 34 - Набор реагентов для определения Тромбинового Времени 5*2 мл<br>№ 35 - Контроль 1, набор реагентов 1*1 мл<br>№ 36 - Контроль 2, набор реагентов 1*1 мл<br>№ 47- Набор реагентов для определения содержания фибриногена;<br>№ 54 - Набор реагентов для опр VIII фактора | г.Алматы, район Ауэзовский, ул.Ташкентская, дом 348/4, 513 | 08.02.2018<br>16:18:00         |

2. Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг-прилагается протоколу об итогах.

3. Рассмотрев представленные ценовые предложения Поставщиков, РЕШИЛ:


3.1. По лотам 32, 33,34,35,36,47,54 - признать закуп несостоявшимся, так как был представлен конверт одним потенциальным поставщиком

Директор ГККП «Областной центр крови»  
Мангистауского областного  
Управления здравоохранения

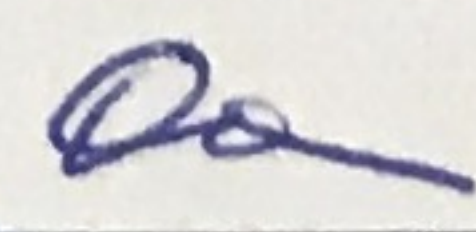 . Сарсамалиев Р.В.


Уполномоченный представитель  
Организатора закупок,  
Менеджер по гос.Закупкам

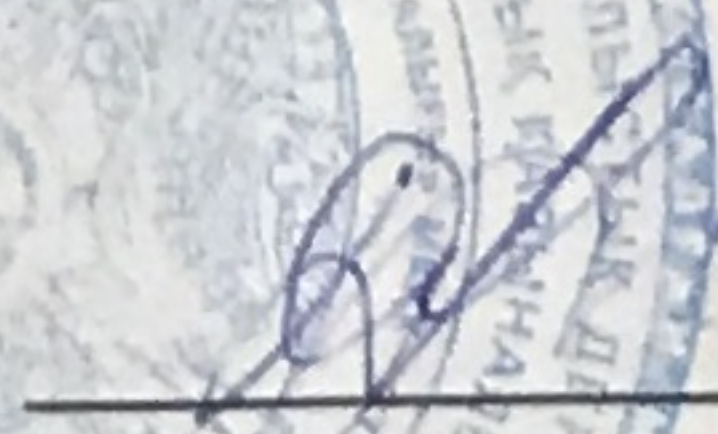

 Дүйшова П.К.

Приложение  
к протоколу итогов от  
12.02.2018 г.

| № лота | Наименование товаров                                                                                             | Описание товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ед.изм | Кол-во | Выделенная сумма для закупок за ед. | ТОО "ШерКом Сервис" |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------|---------------------|
| 32     | Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинного Времени 5*2 мл, (эллаговая кислота) | Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинного Времени 5*2 мл, (эллаговая кислота)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт     | 4      | 6 156                               | 5 850               |
| 33     | Набор реагентов для определения Протромбинового Времени 5*2 мл                                                   | Набор реагентов для определения Протромбинового Времени 5*2 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 4      | 8 535,6                             | 8 120               |
| 34     | Набор реагентов для определения Тромбинового Времени 5*2 мл                                                      | Набор реагентов для определения Тромбинового Времени 5*2 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт     | 4      | 12 819,60                           | 6 820               |
| 35     | Контроль 1, набор реагентов 1*1 мл                                                                               | Контроль 1, набор реагентов 1*1 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 4      | 7 124,40                            | 6 820               |
| 36     | Контроль 2, набор реагентов 1*1 мл                                                                               | Контроль 2, набор реагентов 1*1 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 4      | 7 304,40                            | 7 120               |
| 47     | Набор реагентов для определения содержания фибриногена                                                           | (Тромбин для определения содержания фибриногена 6*2 мл, Референсная плазма для определения фибриногена 1*1 мл, Буфер имидизаловый 2*75 мл, Тромбин для определения содержания фибриногена)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 10     | 41 842,8                            | 36 840              |
| 54     | Набор реагентов для опр VIII фактора                                                                             | Тех фактор VIII-тест предназначен для количественного определения фактора VIII в плазме крови. Принцип метода: Определяют время свертывания плазмы крови в смеси, содержащей дефицитную по фактору VIII плазму, разведенную исследуемую плазму и АПТВ-реагент, в присутствии ионов кальция. Количественное определение активности фактора VIII выполняют по графику зависимости активности фактора VIII от времени свертывания в АПТВ-тесте. Дефицитная по фактору VIII плазма, на 2,0 мл - 1фл. Контрольная плазма на 1,0 мл- 1 фл. АПТВ-реагент, жидкий 2,5мл-1фл. Кальция хлорид 0,025 М, 10мл-1фл. Буфер Трис-НСI 5,0 мл - 1фл. | уп     | 5      | 28000                               | 27 840              |

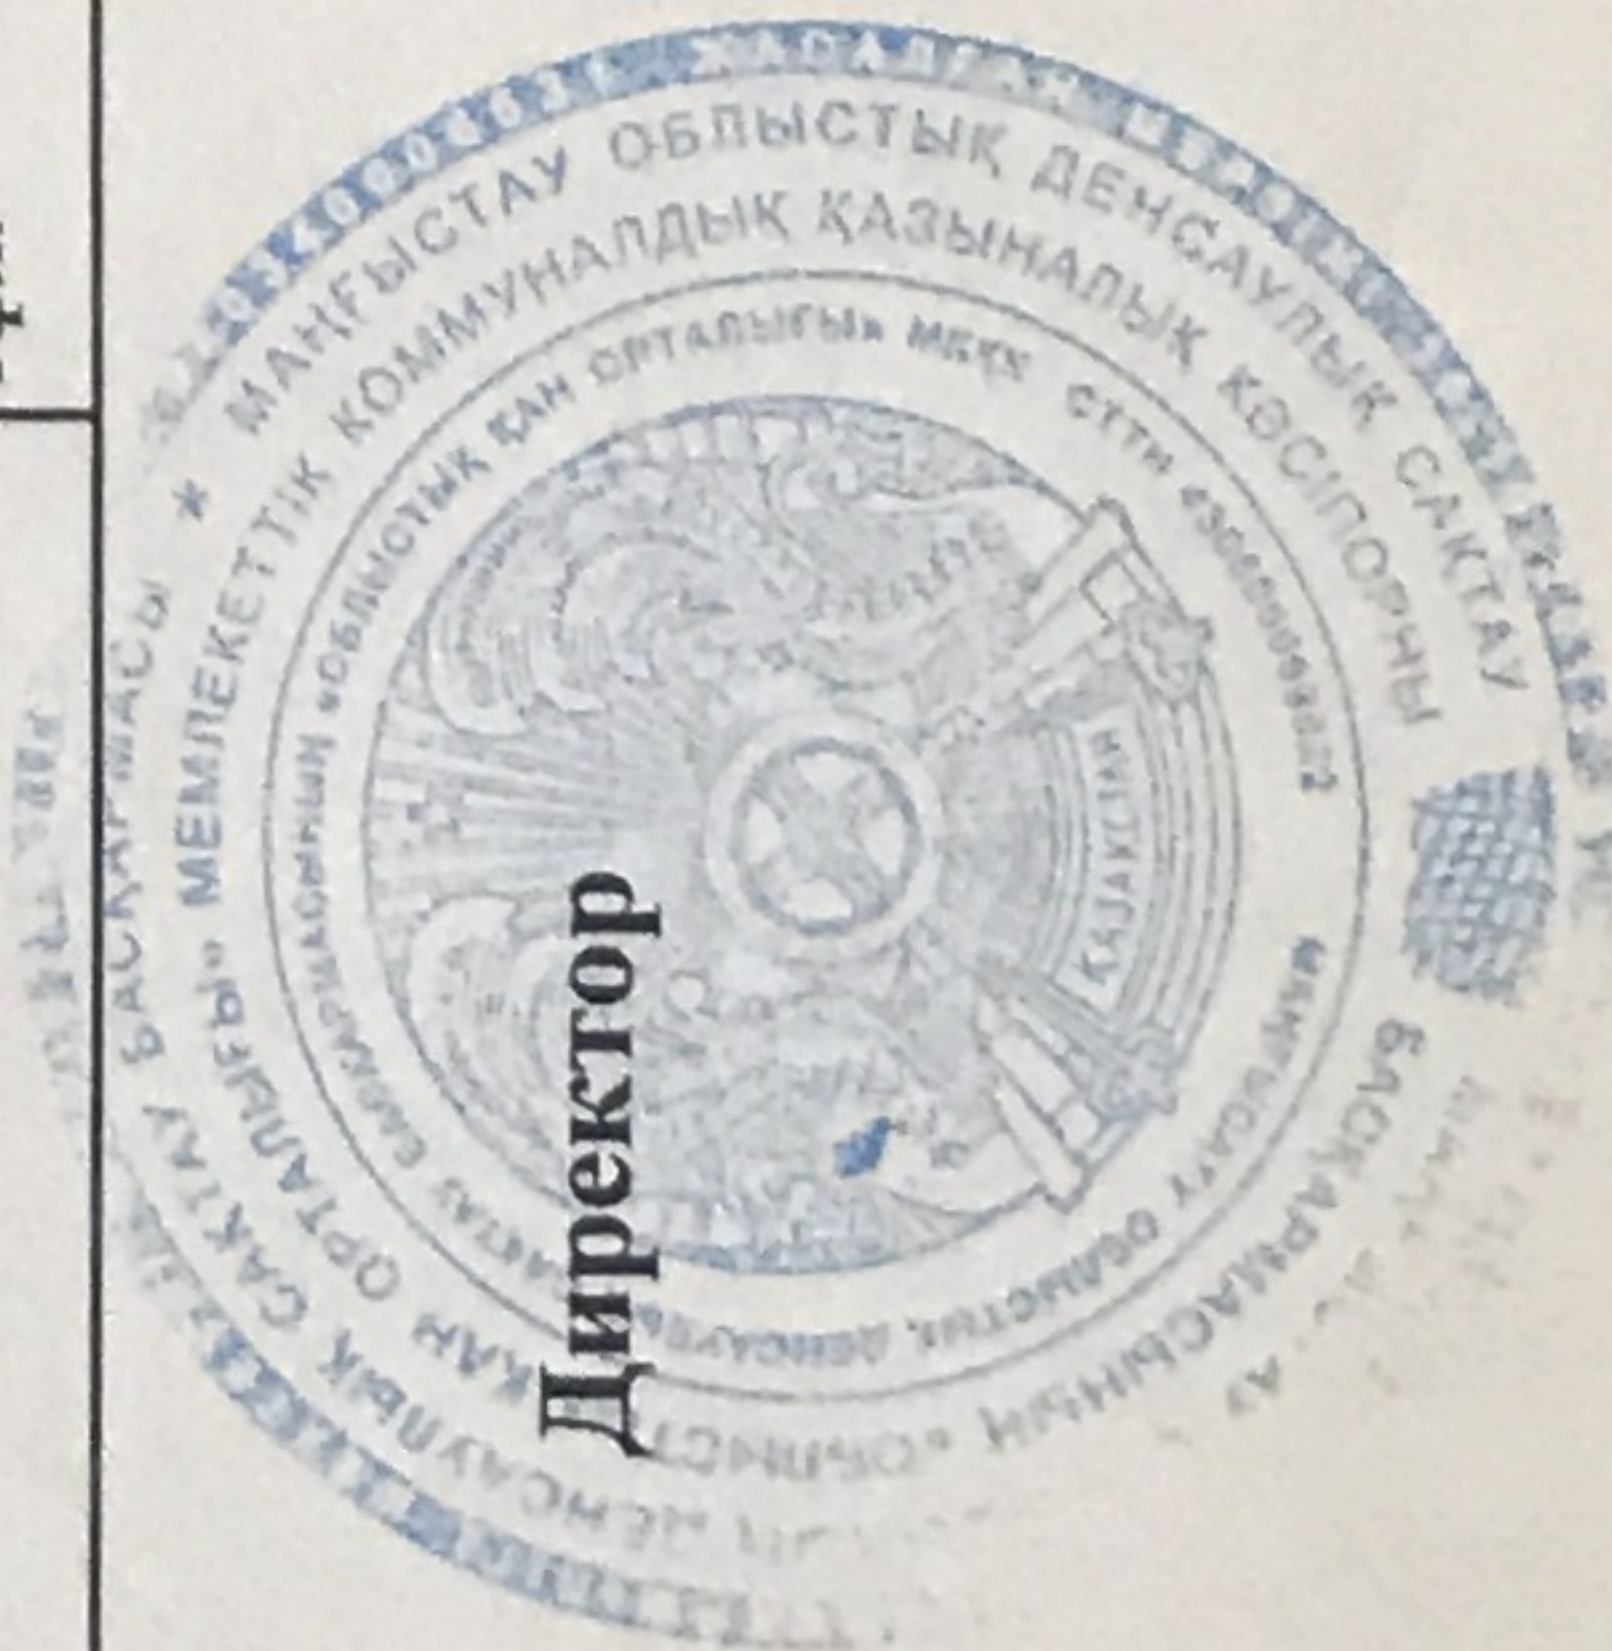

Директор

Сарсамалиев Р.В.

**Протокол об итогах закупа способом из одного источника на приобретение реагентов  
для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в ГККП  
«Областной центр крови»**

Г.Актау

12.02.2018 года

1. Организатор/Заказчик закупок: ГККП «Областной центр крови», 34А мкр., здание центр крови, провела закуп способом из одного источника на основании п.п 2) п.116 по Постановлению Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования» (далее-Правила) по закупке изделий медицинского назначения осуществляет закуп способом из одного источника, так как закупки способом запроса ценовых предложений признаны несостоявшимися.

2. Сумма, выделенная для закупок 726 188 (семьсот двадцать шесть тысяч сто восемьдесят восемь) тенге 00 тиын.

3. Соответствие поставщика квалификационным требованиям главы 3 и 4 Правил, а также требованиям, установленным п.117 главы 11 Правил - соответствует.

4. Краткое описание закупаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг (приложение №1 к протоколу).

5. Цена договора составляет: 646 520 (шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот двадцать) тенге 00 тиын.

6. Организатор закупок по результатам данных закупок способом из одного источника  
**РЕШИЛ:**

1. Заключение договора на закуп изделий медицинского назначения с ТОО «ШерКомСервис» г.Алматы, район Ауэзовский, ул.Ташкентская, дом 348/4, 513.
2. В срок до 19 «февраля» 2018 года опубликовать на интернет ресурсе [ock.mangystau.kz](http://ock.mangystau.kz) данный протокол итогов.

Директор



Сарсамалиев Р.В.

Приложение к протоколу  
итогов от 12.02.2018 г.

| № лота | Наименование товаров                                                                                             | Описание товара                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ед.изм | Кол-во |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| 32     | Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинного Времени 5*2 мл, (эллаговая кислота) | Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинного Времени 5*2 мл, (эллаговая кислота)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт     | 4      |
| 33     | Набор реагентов для определения Протромбинового Времени 5*2 мл                                                   | Набор реагентов для определения Протромбинового Времени 5*2 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт     | 4      |
| 34     | Набор реагентов для определения Тромбинового Времени 5*2 мл                                                      | Набор реагентов для определения Тромбинового Времени 5*2 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 4      |
| 35     | Контроль 1, набор реагентов 1*1 мл                                                                               | Контроль 1, набор реагентов 1*1 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 4      |
| 36     | Контроль 2, набор реагентов 1*1 мл                                                                               | Контроль 2, набор реагентов 1*1 мл                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт     | 4      |
| 47     | Набор реагентов для определения содержания фибриногена                                                           | (Тромбин для определения содержания фибриногена 6*2 мл, Референсная плазма для определения фибриногена 1*1 мл, Буфер имидизированный 2*75 мл, Тромбин для определения содержания фибриногена)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт     | 10     |
| 54     | Набор реагентов для опр VIII фактора                                                                             | Тех фактор VIII-тест предназначен для количественного определения фактора VIII в плазме крови. Принцип метода: Определяют время свертывания плазмы крови в смеси, содержащей дефицитную по фактору VIII плазму, разведенную исследуемую плазму и АПТВ-реагент, в присутствии ионов кальция.<br>Количественное определение активности фактора VIII выполняют по графику зависимости активности фактора VIII от времени свертывания в АПТВ-тесте.<br>Дефицитная по фактору VIII плазма, на 2,0 мл - 1 фл. Контрольная плазма на 1,0 мл - 1 фл. АПТВ-реагент, жидкий 2,5мл-1 фл. Кальция хлорид 0,025 М, 10мл-1 фл. Буфер Трис-HCl 5,0 мл -1 фл. | уп     | 5      |



Директор

Сарсамалиев Р.В.